

תקנות הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1, 2 ו-6 לחוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשס"ח-2008¹ (להלן – החוק), ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, ולעניין תקנה 2 בהסכמת שר הבריאות, אני מתקין תקנות אלה:

- | | |
|---|-------------------------------|
| <p>1. בתקנות אלה –</p> <p>”חוק ציוד רפואי” – חוק ציוד רפואי, התשע”ב-2012²;</p> <p>”המנהל” ו”הפנקס” – כהגדרתם בחוק ציוד רפואי;</p> <p>”תעודת הרישום” – כמשמעותה בחוק ציוד רפואי.</p> | <p>הגדרות</p> |
| <p>2. מכשיר החייאה יהיה מסוג שרשם המנהל בפנקס כמכשיר החייאה המיועד להצבה במקום ציבורי ובהתאם לאותו רישום והוא יהיה נייד וקל לנשיאה.</p> | <p>דרישות ממכשיר החייאה</p> |
| <p>3. (א) מחזיק מקום ציבורי יציב לפחות מכשיר החייאה אחד במיקום מרכזי ונגיש במקום הציבורי שבהחזקתו.</p> <p>(ב) מחזיק מקום ציבורי יציב במקום הציבורי שבהחזקתו יותר ממכשיר החייאה אחד במיקום מרכזי ונגיש, בהתקיים אחד מאלה:</p> <p>(1) בבניין שבו מעל קומה אחת יוצב מכשיר החייאה אחד לפחות בכל שתי קומות צמודות, שמספר המבקרים בשתייהן יחד כרגיל עשוי לעלות על 500 איש ביום;</p> <p>(2) בקומה שאורכה עולה על 300 מטרים, ומספר המבקרים באותה קומה כרגיל עשוי לעלות על 500 איש, יוצבו מספר מכשירי החייאה כך שהמרחק בין מכשיר החייאה אחד למכשיר החייאה הסמוך לו לא יעלה על מרחק של 300 מטרים.</p> | <p>חובת הצבת מכשיר החייאה</p> |

¹ ס”ח התשס”ח, עמ’ 680; התשע”ב, עמ’... [יושלים מראה המקום של התיקון לחוק]
² ס”ח תשע”ב מס’ 2357, מיום 14.5.2012

(ג) במקום ציבורי בו קיימת עמדת עזרה ראשונה, יוצב מכשיר החייאה אחד מתוך מכשירי ההחייאה שקיימת חובה להציבם על פי תקנות משנה (א) או (ב), בסמוך לעמדת העזרה הראשונה ובלבד שהיא מצויה במקום מרכזי ונגיש.

4. עמדת מכשיר החייאה (א) מחזיק מקום ציבורי יציב את מכשיר ההחייאה בתוך ארון קבוע ייעודי לאחסון מכשיר החייאה (להלן – "עמדת מכשיר החייאה"), שניתן לפתוח אותו בנקל ולהוציא ממנו את מכשיר ההחייאה בקלות; עמדת מכשיר החייאה תוצב בגובה שלא יעלה על 150 סנטימטרים ולא יפחת מ-120 סנטימטרים מגובה הרצפה.

(ב) מחזיק מקום ציבורי יציב שלט בעברית ובערבית על עמדת מכשיר ההחייאה או לצידה לפי התרשים בתוספת הראשונה.

5. שלט המכוון אל מכשיר החייאה מחזיק מקום ציבורי יציב שלט, בעברית ובערבית לפי התרשים בתוספת השנייה בסימונים ובשינויים המחויבים; שלט כאמור יוצב במקום בולט לעין המכוון למכשיר ההחייאה, על פי האמור להלן:

(1) במקום ציבורי במבנה – בכל קומה, בין אם הוצבה בה עמדת מכשיר החייאה, ובין אם לאו באופן שהמרחק בין שלט לשלט בכל קומה לא יעלה על 150 מטרים;

(2) במקום ציבורי שאינו במבנה – בכניסה אליו.

6. הוראות נוספות לעניין השילוט מחזיק מקום ציבורי ידאג כל בשלט לפי תקנה 5 יתקיימו כל אלה:

(1) הוא עשוי חומר קשיח;

(2) הוא מקובע למקומו באופן שאינו ניתן להזזה, להסרה או לתנועה;

(3) אם השלט מוצב במקום חשוך – יותקנו סידורי הארה מתאימים, באופן שמלוא תכנו של השלט יואר.

7. הוראות הפעלה מחזיק מקום ציבורי יתקין בצמוד לעמדת מכשיר החייאה, במקום בולט לעין, הוראות כמפורט בתוספת השלישית לטיפול באדם הזקוק לטיפול באמצעות מכשיר החייאה, בשפה עברית וערבית, שבראשן יצוין כי הפעלת המכשיר היא בידי מי שהוא בעל ידע בהפעלת המכשיר.

8. בדיקות תקינות תקופתיות (א) מחזיק מקום ציבורי יהיה אחראי על תקינות מכשיר ההחייאה ויוודא תקינות הפעלתו ותחזוקתו, באופן שלא יגרע מההוראות שנקבעו בתעודת הרישום.

(ב) מחזיק מקום ציבורי ימנה אחראי שיבדוק אחת לשבוע את שלמות המכשיר, תקינות הסוללות וכי עמדת מכשיר ההחייאה ניתנת לפתיחה בנקל ככל שנקבעה לה דלת או סוגר.

(ג) מחזיק מקום ציבורי יהיה אחראי על תיעוד והחזקה של תוצאות הבדיקה ופירוט תאריכי הבדיקה לפי תקנות משנה (א) ו-(ב); העתק תוצאות הבדיקות מהחודש האחרון, שנערכו לפי תקנת משנה (א), יוחזקו במקום נגיש בסמוך לעמדת מכשיר ההחייאה; תוצאות הבדיקות שנערכו ב-12 החודשים האחרונים לפחות יוחזקו במשרדי מחזיק המקום הציבורי.

(ד) מחזיק מקום ציבורי יציג את תוצאות הבדיקות למפקח שמונה לפי החוק, על פי דרישתו.

9. מחזיק מקום ציבורי ישלח למשרד הכלכלה לא יאוחר מיום 31 בדצמבר בכל שנה, תצהיר חתום ומאומת על ביצוע בדיקות התקינות התקופתיות למכשיר ההחייאה, על פי הנוסח המפורט בתוספת הרביעית.

תצהיר

10. עד לתחילתו של חוק ציוד רפואי יראו לענין תקנות אלה מכשיר החייאה הרשום בפנקס האבזרים והמכשירים הרפואיים המתנהל במשרד הבריאות, כאילו נרשם בפנקס לפי סעיף 2 לחוק האמור, ורישומו יהיה תקף עד תום תקופת תוקפו של הרישום כאמור, אלא אם כן נמחק קודם לכן לפי הוראות חוק ציוד רפואי.


הוראת מעבר

תוספת ראשונה
תקנה 4(ב)



תוספת שניה

תקנה 5

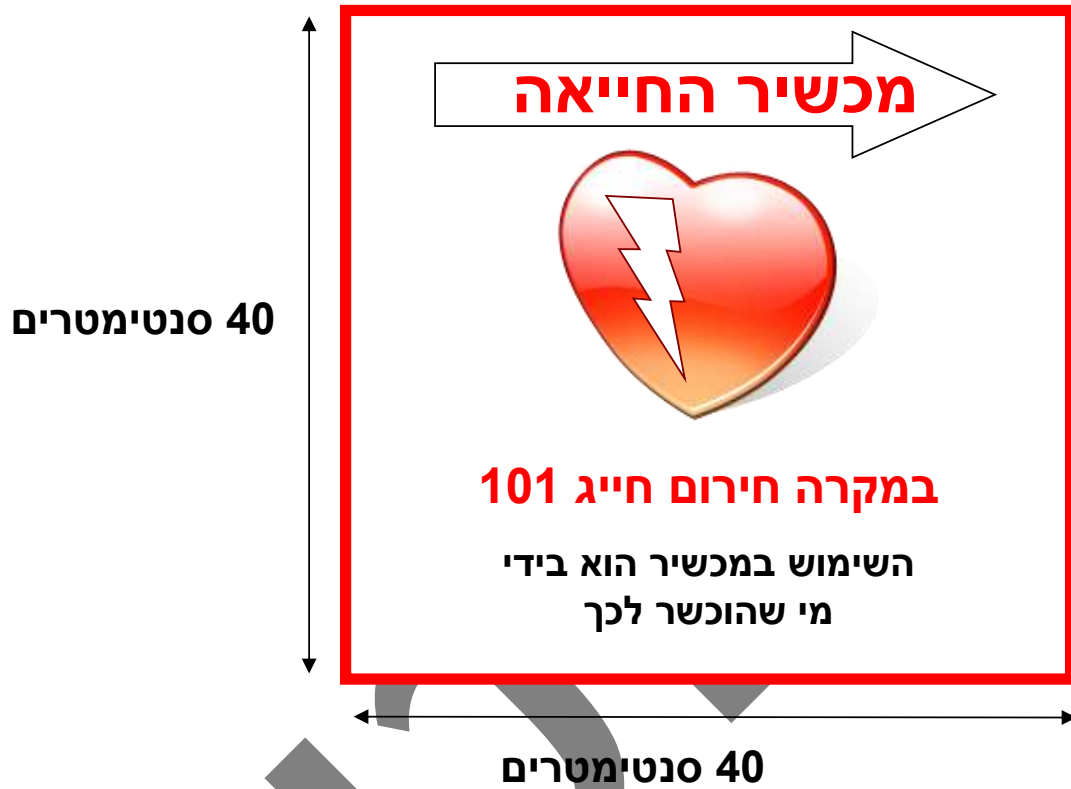

תוספת שלישית
תקנה 7

הוראות פעולה לטיפול באדם הלוקה בליבו

הפעלת המכשיר היא בידי מי שהוכשר לכך

- 1 • אם הנפגע אינו מגיב
- 2 • קרא לעזרה – חייג 101
- 3 • דאג להבאת מכשיר החייה (דפיברילטור)
- 4 • עד להגעת מכשיר החייה, החל בביצוע עיסויי חזה, לחץ מהר ועמוק במרכז בית החזה
- 5 • עם הגעת מכשיר החייה, הפעל אותו ופעל בהתאם להנחיות המכשיר

40 סנטימטרים

40 סנטימטרים

תוספת רביעית

תקנה 9

לכבוד משרד הכלכלה/ המפקח על מכשירי החייאה

תצהיר

אני הח"מ _____ מספר ת.ז. _____, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כי מכשיר החייאה שברשותי הוא ציוד רפואי רשום בהתאם לחוק ציוד רפואי, התשע"ב-2012 / רשום בפנקס האבזורים והמכשירים הרפואיים המתנהל במשרד הבריאות (כל עוד חוק ציוד רפואי, התשע"ב-2012, לא נכנס לתוקפו) וכי הוא הותקן על פי דרישות כל דין, ונבדק מדי שבוע בשנה האחרונה על ידי אחראי שמיניתי בהתאם לתקנות, וכן נבדק בתאריך על ידי בהתאם להוראות תעודת הרישום. כן מצהיר אני בזאת כי המכשיר תקין כעת וכי כל ליקוי אשר התגלה בו כתוצאה מבדיקות תקינות אלה במהלך השנה האחרונה תוקן בהתאם להוראות היצרן.

להלן פרטי המכשיר:

סוג המכשיר.....

כתובת המקום הציבורי בו הוא מותקן.....

שם האחראי שמונה על ידי.....

תאריך.....חתימה.....חותמת.....

אני הח"מ, _____ עורך/ עורכת דין, מאשרת בזה כי ביום _____ הופיע בפני שזיהיתי אותו על ידי תעודת זהות מספר _____ ולאחר שהוזהרתי אותו כי עליו לומר את האמת כולה, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה דלעיל, וחתם עליה בפני.

תאריך.....חתימה.....חותמת.....

התשע"ב _____

(ב _____ 2012)

(חמ 3-4101)